

Juntas de silicona 5000 pequeñas



Juntas de silicona serie 5000

Características y ventajas

- Números de lote grabados con láser para una trazabilidad completa del material (también disponible la versión sin grabado con láser)
- Diseñadas según las normas ASME-BPE
- Cumplen con la farmacopea estadounidense (USP) clase VI y están libres de componentes de origen animal (ADCF)
- Cumplen con las normativas de la FDA CFR 21 177.2600
- Estables a la radiación gamma y esterilizables en autoclave
- Bajo perfil de extraíbles
- Con doble embolsado y termoselladas




Especificaciones técnicas

	Juntas de silicona 5000 pequeñas
Tipo de junta	Sin brida
Diámetro interno	10.9 - 16 mm
Diámetro interno	0.43 - 0.63 pulg.
Diámetro exterior	21.6 mm
Diámetro exterior	0.85 pulg.
Tamaño	0.5, 0.75 pulg.
Cantidad	25 unidades
Certificación	ADCF, ISO 10993, ISO Clase 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP clase VI
Rango de temperatura de trabajo	-55 °C a 210 °C
Rango de temperatura de trabajo	-67 °F a 410 °F
Vida útil	5 años
Estabilidad a la radiación gamma	Máx. 50 kGy

Materiales de construcción

	Juntas de silicona 5000 pequeñas
Material	Silicona curada al platino

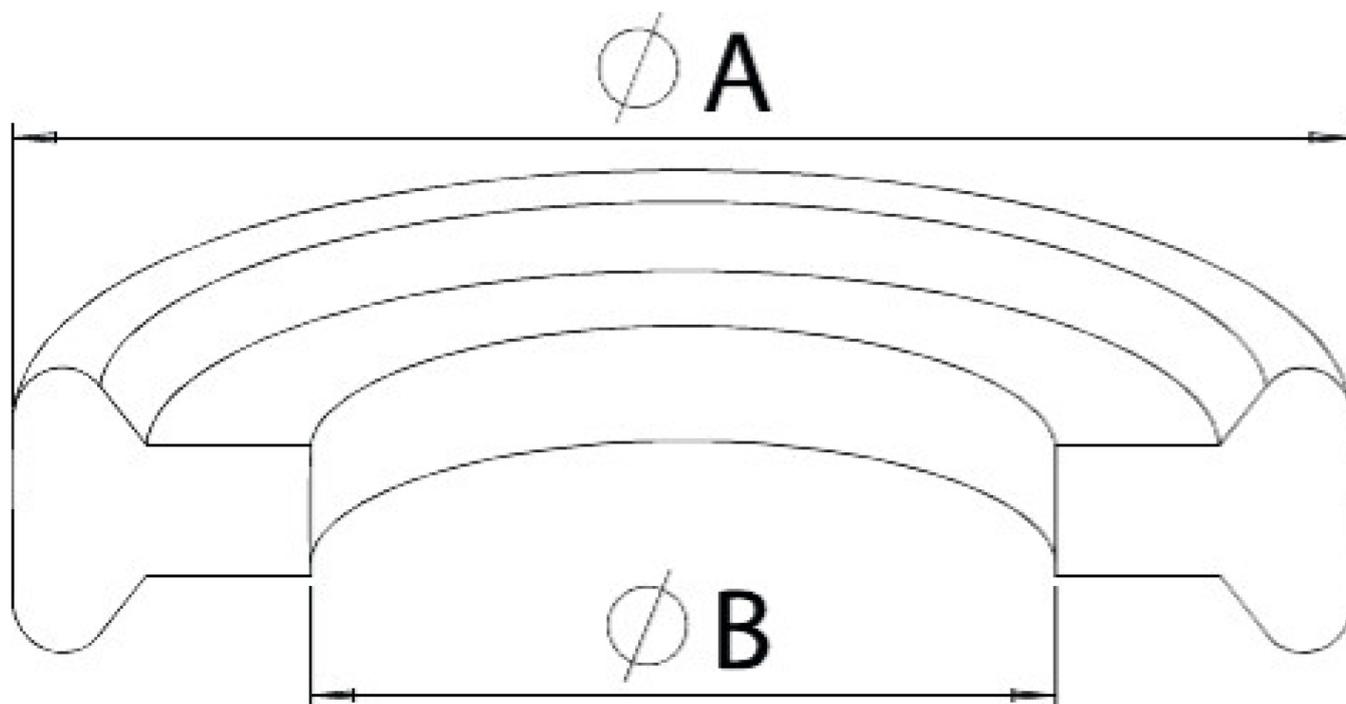

Junta BioPure de silicona de alta pureza curada al platino, con grabado láser				
Número de pieza	Tamaño en pulg.	Diám. ext. en pulg. (A)	Diám. int. en pulg. (B)	Cantidad
5001.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5001.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25
Junta BioPure de silicona de alta pureza curada al platino				
Número de pieza	Tamaño en pulg.	Diám. ext. en pulg. (A)	Diám. int. en pulg. (B)	Cantidad
5201.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5201.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow y puresu son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve y BioTube applicator son marcas registradas de BioPure Technology Limited. Triclamp es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp se utiliza con licencia.

wmfts.com/global



20 February 2024