

Standardní těsnění Silicone 5000



Silikonová těsnění řady 5000

Vlastnosti a výhody

- Laserem gravírovaná čísla šarží pro úplnou sledovatelnost materiálu (k dispozici je také verze bez laserového gravírování)
- Navrženo v souladu s normami ASME-BPE
- V souladu s USP třídy VI a bez složek živočišného původu (ADCF)
- Vyhovuje předpisům FDA CFR 21 177.2600
- Gama stabilní a autoklávovatelné
- Nízký profil extrahovatelných látek
- Dvojitě zabalené a tepelně zatavené




Technické specifikace

	Standardní těsnění Silicone 5000
Typ těsnění	Bez příruby
Vnitřní průměr	22.9 - 147.8 mm
Vnitřní průměr	0.9 - 5.82 palce
Vnější průměr	50.3 - 165.4 mm
Vnější průměr	1.98 - 6.51 palce
Velikost	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 palce
Množství	25 ks
Certifikace	ADCF, ISO 10993, Ph. Eur. 3.1.9, Třída ISO 7, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP třídy VI
Rozsah provozní teploty	-55 °C až 210 °C
Rozsah provozní teploty	-67 °F až 410 °F
Skladovatelnost	5 let
Stabilita gama	Max. 50 kGy

Konstrukční materiály

	Standardní těsnění Silicone 5000
Materiál	Silikon vulkanizovaný platinou

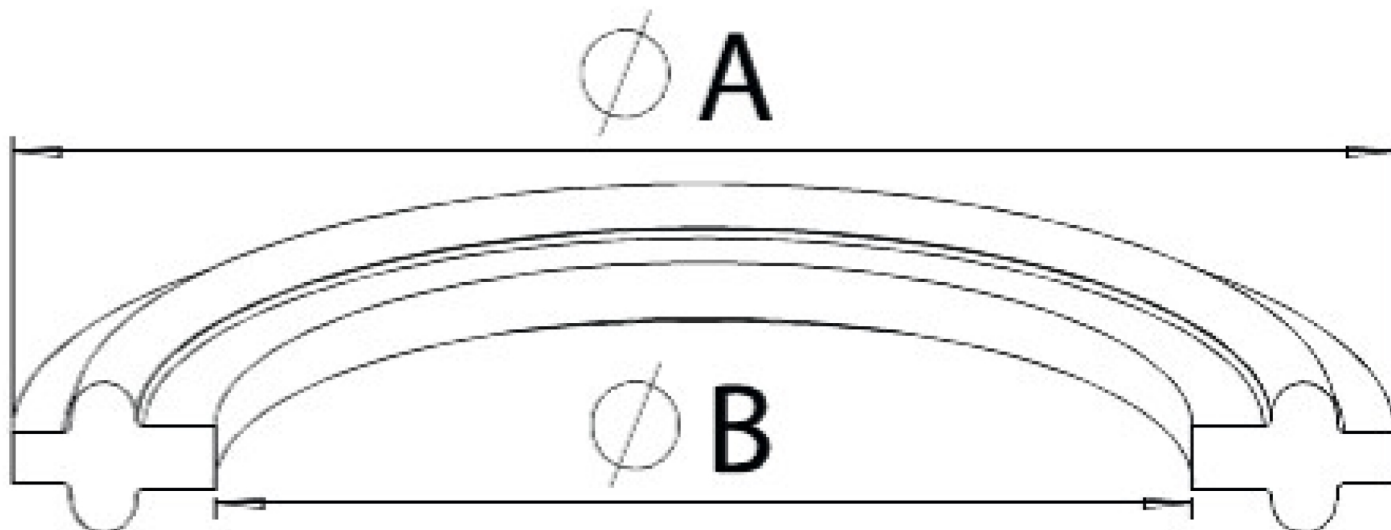

Vysoce čisté těsnění BioPure ze silikonu vulkanizovaného platinou - laserově gravírované				
Číslo dílu	Velikost v palcích	Vnější průměr, palce (A)	Vnitřní průměr, palce (B)	Množství
5001.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
5001.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
5001.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
5001.0250.025	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
5001.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
5001.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
5001.0600.025	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25
Vysoce čisté těsnění BioPure ze silikonu vulkanizovaného platinou				
Číslo dílu	Velikost v palcích	Vnější průměr, palce (A)	Vnitřní průměr, palce (B)	Množství
5201.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
5201.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
5201.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
5201.0250.025	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
5201.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
5201.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
5201.0600.025	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

Zřeknutí se odpovědnosti: Informace uvedené v tomto dokumentu jsou v době vydání považovány za správné. Společnost Watson-Marlow Limited však nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakoukoli v něm obsaženou chybu a vyhrazuje si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. Za zajištění vhodnosti produktu pro použití v rámci své aplikace odpovídá uživatel. Watson-Marlow a WMArchitect jsou registrované ochranné známky společnosti Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve a BioTube Applicator jsou ochranné známky společnosti BioPure Technology Limited. Tri-Clamp je registrovanou obchodní značkou společnosti Alfa Laval Corporate AB. Svorka Q-Clamp se vyrábí na základě licence.

wmfts.com/global



05 July 2024